



Protocolos de sincronización para IATF

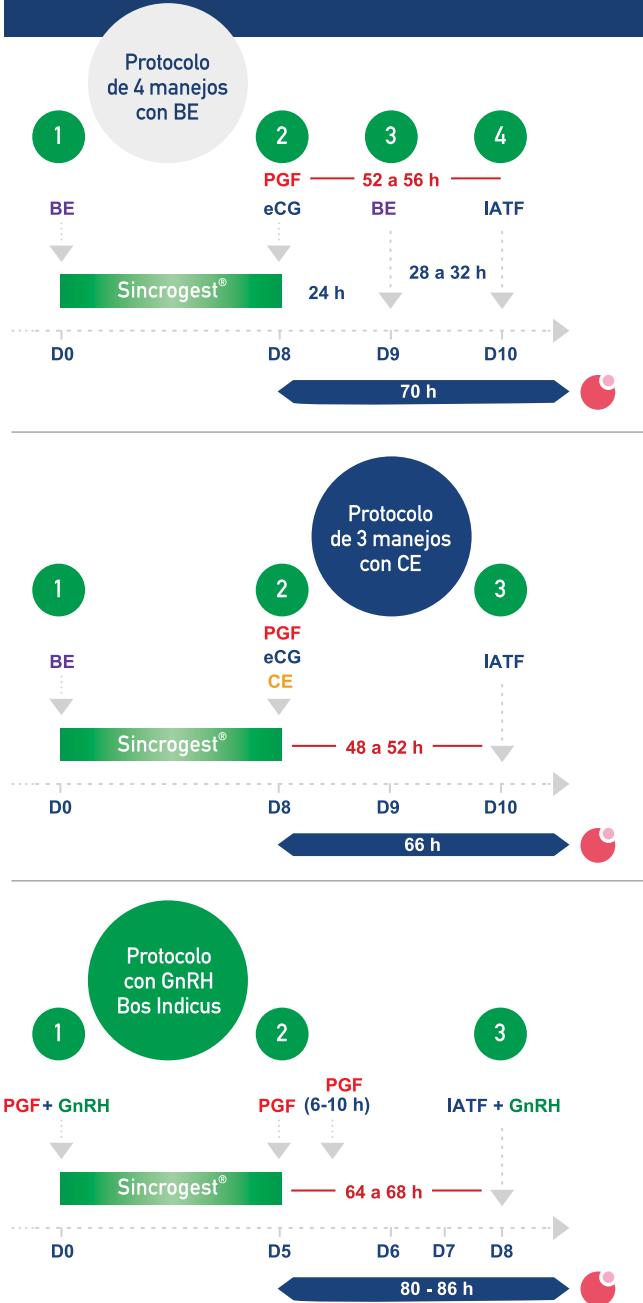


Protocolos con PGF2 alfa y GnRH

Momento de la segunda GnRH

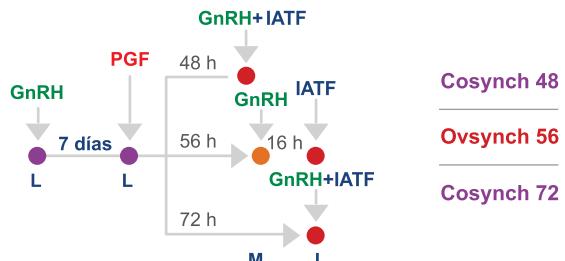

Opciones Presynch-Ovsynch

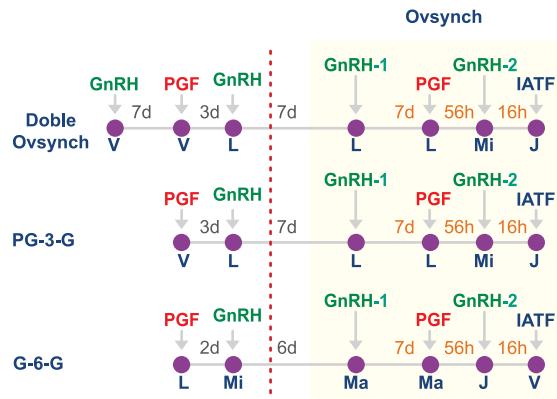

Consulte siempre un Médico Veterinario.

LíneaSincro

La experiencia brasileña en reproducción bovina al servicio de la ganadería mexicana.



ourofino
saúde animal

Si es Ourofino
es garantía de calidad.

Ouro Fino de México S.A. de C.V.
tel. 01 (33) 3620 3812
01 (33) 3620 8001
sac@ourofino.com

Guía Rápida de Protocolos de Sincronización para IATF

	Protocolo de 4 manejo para vacas:						
	lunes	martes	miércoles	jue	vie	sáb	dom
Insertar dispositivo Sincrogest® + 2 ml de Sincrodiol®							
lunes	martes	miércoles	jue	vie	sáb	dom	
Retirar Sincrogest® + 2 ml de Sincrocio® + 400 UI eCG	1ml Sincrodiol® 24 hrs. después de retirar Sincrogest®	IATF 52-56 hrs. después de retirar Sincrogest®					
lunes	martes	miércoles	jue	vie	sáb	dom	
Insertar dispositivo Sincrogest® + 2 ml de Sincrodiol® + 1 ml de Sincrocio®							
Retirar Sincrogest® + 1 ml de Sincrocio® (Aplicar 2ml si el dispositivo es reutilizado) + 300 UI eCG	1ml Sincrodiol® 24 hrs. después de retirar Sincrogest®	IATF 52-56 hrs. después de retirar Sincrogest®					
lunes	martes	miércoles	jue	vie	sáb	dom	
Insertar dispositivo Sincrogest® + 2 ml de Sincrodiol®							
Retirar Sincrogest® + 2 ml de Sincrocio® + 400 UI eCG + 1ml de SincroCP®		IATF 48-52 hrs. después de retirar Sincrogest®					
lunes	martes	miércoles	jue	vie	sáb	dom	
Insertar dispositivo Sincrogest® + 2 ml de Sincrodiol® + 1 ml de Sincrocio®							
Retirar Sincrogest® + 1 ml de Sincrocio® (Aplicar 2ml si el dispositivo es reutilizado) + 300 UI eCG +0.5 ml SincroCP®		IATF 48-52 hrs. después de retirar Sincrogest®					
lunes(0)	martes(1)	mié(2)	jue(3)	vie(4)	sábado(5)	dom(6)	
Insertar dispositivo Sincrogest® + 2 ml de Sincrodiol® + 2.5 ml de Sincroforte®					Retirar Sincrogest® + 2 ml de Sincrocio® AM + 2 ml de Sincrocio® PM		
lunes(7)	martes(8)	mié	jue	vie	sábado	dom	
	IATF + 2.5 ml de Sincroforte® 64-68 hrs después de retirar Sincrogest®						



LíneaSincro

Sincrodiol®
S.A.G.A.R.P.A. Q-7750-055

Sincroforte®

S.A.G.A.R.P.A. Q-7750-060

Sincrogest®

S.A.G.A.R.P.A. Q-7750-056

Sincrocio®

S.A.G.A.R.P.A. Q-7750-014

SincroCP®

S.A.G.A.R.P.A. Q-7750-069

ourofino
saúde animal

Si es Ourofino es garantía de calidad.